

## Процедура Перезагрузки Комплекса «СветЛ» (первое поколение)



Прежде чем производить эту «Процедуру», запишите на отдельном листе бумаги все Ваши текущие позиции, установленные на Комплексе в Разделах:

### **«СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА» «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ»**

Это Вам понадобится в дальнейшем.

1. Корректно запустить Комплекс «СветЛ».

## Последовательность действий

2. Войти в Раздел «Контроль Нагрузки» и отключить Программу «СветЛ» в Разделах:

### «СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА» «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ»

следующим действием: нажимая на любое изображение выбранного ранее Вами органа появится четыре пункта меню и выберав пункт:

#### «Убрать все органы и заболевания»

Подтвердив удаление кнопкой «ДА». Раздел «Контроль нагрузки» – «обнулится» (очистится).



*Универсал*

3. Вернитесь на Главный Экран.


4. Нажмите механическую кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (сбоку планшетного компьютера) и удерживая её, дождитесь появления на экране ТАБЛО «Завершить работу». Нажмите «ОК». Комплекс «СветЛ» выключится.

5. Подождите **не менее 10 минут**.

6. Включите Комплекс механической кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» и войдите в Программу «СветЛ» на Главный Экран.

7. Войдите в Раздел «Контроль Нагрузки» и проверьте удаление ранее набранных позиций. Если там остались прежние, повторите процедуру (п. 1-5). Если Раздел «Контроль Нагрузки» «чистый» и не заполненный – вернитесь на Главный Экран.

8. Установите на Комплексе все Ваши записанные позиции, в соответствии с «Инструкцией Пользователя», не забывая устанавливать «МОЩНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ» на каждую позицию – 100 % (некоторые позиции можно изменить, по Вашему усмотрению или согласно рекомендаций).
9. После установки всех Ваших позиций, можете «установить» ту мощность (которая Вам «комфортна») на Комплексе, на Главном Экране – «общим ползунком» **(Общая Интенсивность)**.
10. Выйдите из Программы и выключите Комплекс механической кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» и табло «Завершить работу».
11. Подождите **не менее 10 минут**.
12. Включите Комплекс (как это Вы делаете всегда) и он начал работать.
13. Далее действуйте в соответствии с привычным Вам использованием Комплекса «СветЛ».

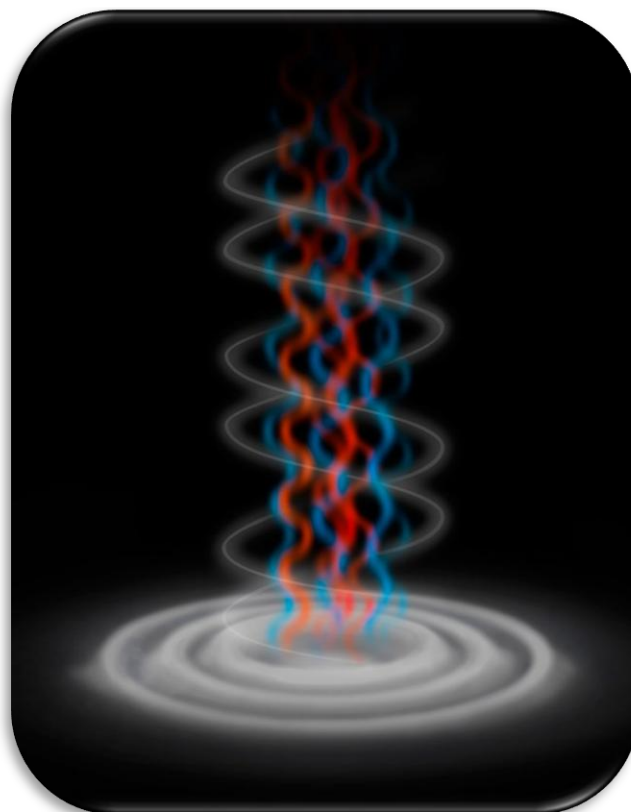

05.10.2019 г.